

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА МАРИНА” ЕАД, ВАРНА

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 04.05.2015 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Р-266/22.04.2015 г. на Изпълнителен Директор на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Ганева – Юрисконсулт на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна.

ЧЛЕНОВЕ:

- 1. Доц. д-р Теменуга Стоева, дм** - Ръководител направление МДЛ и Началник на Лаборатории по микробиология и вирусология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна.
- 2. Доц. д-р Петър Ганев, дм** - Началник Клиника по обща и клинична патология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна.
- 3. Доц. д-р Лилия Иванова, дм** – Лекар в лаборатория по Микробиология и Вирусология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна.
- 4. Г-жа Нюлюфер Якуб** – Експерт „Маркетинг” в направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна.

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:

Г-н Николай Николов – Ръководител направление „МД и ТИО” в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, („Комисията”),

се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години, открита с Решение Р-175 от 10.03.2015 г., на Директор „Икономически Дейности”, упълномощено лице, в следния ред:

1. Оферта с Вх. № ВК – 638/08.04.2015 г. на „Елта 90М” ООД.

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че те отговарят на изискванията посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик 2. Комисията няма забележки към предложението на фирма „Елта 90М” ООД и го допуска до оценяване по обособени позиции А, В и С.

2. Оферта с Вх. № ВК – 694/20.04.2015 г. на „Омнимед” ЕООД.

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че те отговарят на изискванията, посочени в документацията. След това бяха разгледани документите в Плик 2. Комисията няма забележки към предложението на фирма „Омнимед” ЕООД и го допуска до оценяване по обособена позиция D.

3. Оферта с Вх. № ВК – 715/21.04.2015 г. на „Ридаком” ЕООД.

След проверка на представените от участника документи в Плик 1, Комисията установи, че в представения каталог на производителя HiMediaLaboratories не е отбелязано, с кой продукт за коя позиция (1-82) от група А се участва. На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, Комисията изисква от „Ридаком” ЕООД, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, да предостави на Комисията:

Списък, попълнен в следната форма:

Тестове и реактиви за Лаборатория по Микробиология			
Група и № по ред	Наименование	Търговско наименование на продукта и каталожен номер	Номер на страница в представения каталог
1	2	3	4
А 1	Азитромицин 15 мг.		
...			
...			
А 82	Кампилобактер селективен суплемент на Престон 1x10 виалки		

Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен (CD) носител.

4. Оферта с Вх. № ВК – 716/21.04.2015 г. на „Аквахим“ АД.


След проверка на представените от участника документи в Плик 1, комисията установи, че на представените:

1. Каталог от 2007 г. за LAB Vision Products на производителя Thermo Scientific;
2. Брошура Thermo Scientific Dewax and HIER Buffers на производителя Thermo Scientific;
3. Цветни разпечатки:
 - Thermo Scientific UltraVision Quanto Complete Kit на производителя Thermo Scientific;
 - Thermo Scientific IHC Products – Comprehensive Breast Pathology на производителя Thermo Scientific;
 - Thermo Scientific Prostate Pathology на производителя Thermo Scientific;
 - Thermo Scientific UltraVision Quanto for Immunohistochemistry.

не е отбелязано, с кой продукт за коя позиция (1-92) от група D се участва.

На стр. 20 от Офертата в Плик 1, Комисията откри Декларация от участника „Аквахим“ АД, че „Thermo Lab Vision“ е „зелена компания“ и няма актуален каталог на хартиен носител, поради която причина са представени стари такива.

В същата декларация участникът е посочил адрес в Интернет – <http://www.thermoscientific.com>, на който Комисията може да открие и ползва актуални електронни каталози. На горепосочения адрес се отваря следната страница:

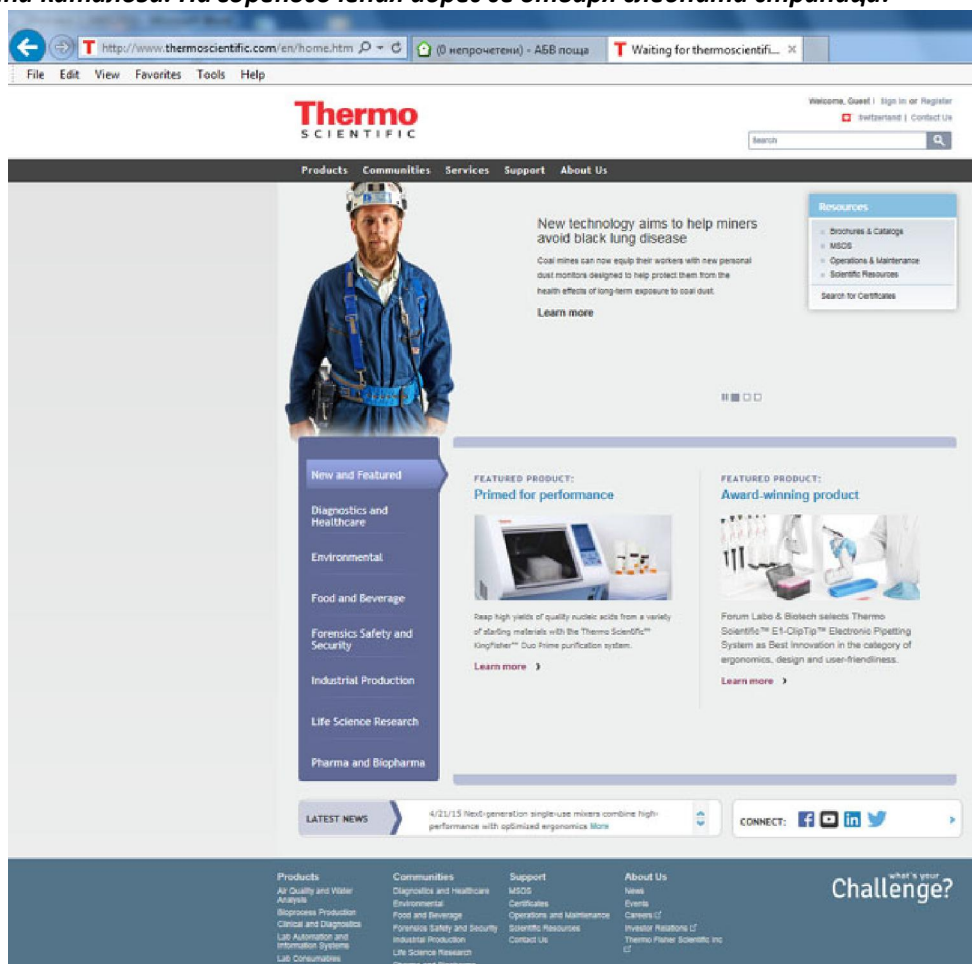

На нея се вижда, че същата представлява интернет адрес на Thermo Scientific, като участникът не е посочил ясно конкретни препратки към интернет каталог/зи за позиции (1-92) от група D.

На основание чл. 68, ал. 7, 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, Комисията изисква от „Аквахим“ АД, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, да предостави на Комисията: